

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第5648992号  
(P5648992)

(45) 発行日 平成27年1月7日(2015.1.7)

(24) 登録日 平成26年11月21日(2014.11.21)

(51) Int.CI.

F 1

G 0 1 N 27/62

(2006.01)

G 0 1 N 27/62

F

H 0 1 J 49/04

(2006.01)

H 0 1 J 49/04

H 0 1 J 49/24

(2006.01)

H 0 1 J 49/24

請求項の数 3 (全 10 頁)

(21) 出願番号

特願2010-104211 (P2010-104211)

(22) 出願日

平成22年4月28日 (2010.4.28)

(65) 公開番号

特開2010-286476 (P2010-286476A)

(43) 公開日

平成22年12月24日 (2010.12.24)

審査請求日

平成25年1月18日 (2013.1.18)

(31) 優先権主張番号

特願2009-115803 (P2009-115803)

(32) 優先日

平成21年5月12日 (2009.5.12)

(33) 優先権主張国

日本国 (JP)

(73) 特許権者 505374783

独立行政法人日本原子力研究開発機構  
茨城県那珂郡東海村村松4番地49

(73) 特許権者 591058792

日本金属化学株式会社  
東京都練馬区旭町3-12-19

(74) 代理人 100108855

弁理士 蔵田 昌俊

(74) 代理人 100091351

弁理士 河野 哲

(74) 代理人 100088683

弁理士 中村 誠

(74) 代理人 100109830

弁理士 福原 淑弘

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】高感度ガス分析装置、ガス定量方法及び分析装置システム

## (57) 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

微量ガスを定量測定する高感度ガス分析装置において、  
被測定ガスを収容する被測定ガスリザーバと、  
この被測定ガスリザーバと第1の開閉弁を介して接続する小容器と、  
この小容器と第2の開閉弁を介して接続する、容量が前記小容器の容量の2000倍以上  
上のバッファタンクと、  
このバッファタンクと配管を介して接続するマニホールドと、  
このマニホールドと接続する、吸気口側に第3の開閉弁を介装したターボ分子ポンプ及びダイヤフラムポンプからなる真空排気装置の付いた四極子型質量分析計と、  
被測定ガスを四極子型質量分析計に流入させるためのオリフィスと、  
前記マニホールドとターボ分子ポンプとを接続する、第4の開閉弁を介装したバイパス配管とを具備し、

前記第3の開閉弁及び前記第4の開閉弁は、前記第4の開閉弁の開又は閉動作に対応して前記第3の開閉弁の動作が前記第4の開閉弁とは正反対の閉又は開動作となるように連動動作する

ことを特徴とする高感度ガス分析装置。

## 【請求項 2】

請求項1記載の高感度ガス分析装置を用いたガス定量方法であって、

前記被測定ガスリザーバに収容されている被測定ガスを前記第1および第2の開閉弁を

10

20

操作して前記小容器に一定容積の被測定ガスを採取する工程と、

前記真空排気装置を作動させた後、前記第1の開閉弁を閉じてから前記第2の開閉弁を開いて前記小容器内の被測定ガスを前記バッファタンク内に拡散させる工程と、

拡散した被測定ガスを前記バッファタンクと前記マニホールド間の配管を介して前記マニホールドに移す工程と、

前記マニホールド内の被測定ガスを、前記オリフィスを介して前記四極子型質量分析計のイオン源に供給して被測定ガスをイオン化する工程と、

イオン化した被測定ガスのイオン電流を測定することにより被測定ガス中の対象ガスの定量を行う工程とを具備し、

前記マニホールド内の被測定ガスを、前記オリフィスを介して前記四極子型質量分析計のイオン源に供給して被測定ガスをイオン化する工程において、前記マニホールド内の被測定ガス圧が前記四極子型質量分析計の正常動作圧力の上限値を超えた場合に、前記バイパス配管を経由して余分な量の被測定ガスを系外へ排出するために、前記四極子型質量分析計とターボ分子ポンプとの間に介装された第3の開閉弁及び前記マニホールドとターボ分子ポンプとを接続するバイパス配管に介装された第4の開閉弁を、前記第4の開閉弁の開又は閉動作に対応させて前記第3の開閉弁の動作を前記第4の開閉弁とは正反対の閉又は開動作とするように連動動作させることを特徴とするガス定量方法。10

### 【請求項3】

請求項1記載の高感度ガス分析装置と、この高感度ガス分析装置による分析の解析を行うホストコンピュータと、前記高感度ガス分析装置と前記ホストコンピュータ間で分析情報及び解析結果情報のやり取りを行う有線又は無線による連絡機構とを具備することを特徴とする高感度ガス分析装置システム。20

### 【発明の詳細な説明】

#### 【技術分野】

#### 【0001】

本発明は、大気等に含まれる微量ガスを繰返し高感度で定量することができるガス分析装置、ガス定量方法及び分析装置システムに関する。詳しくは、大気中の特定ガス、自動車排気ガス中の有害ガス、呼気中の特定ガス、構造材に含まれる特定ガスなどの微量ガスを最高 ppmオーダーの高い感度で測定することができる質量分析法によるガス分析装置、ガス定量方法及び分析装置システムに関する。30

#### 【背景技術】

#### 【0002】

大気等に含まれる微量ガスを質量分析法により測定する場合には、測定しようとするガス（対象ガス）を含む大気等（被測定ガス）を連続的に質量分析計のイオン源に流し込む必要がある。しかしながら、大気圧かそれに近い圧力の被測定ガス圧力と質量分析計が正常に作動する圧力の間には1億倍（ $10^8$ ）以上の差を生じさせる必要があるため、数段の差動排気を行うとともに、質量分析計イオン源へのガス流入口の孔径を極度に小さくして質量分析計の作動に適した  $10^{-2}$  Pa 以下の測定圧力を創出している。

#### 【0003】

即ち、従来のガス分析装置は、図3に示すような構成となっている。同装置は、被測定ガスリザーバ1と、可変リークバルブ2と、マニホールド3と、ターボ分子ポンプ4及びダイヤフラムポンプ5からなる真空排気装置6と、被測定ガスリザーバ1とマニホールド3を結ぶ配管7aと、マニホールド3とターボ分子ポンプ4を結ぶ配管7bと、ターボ分子ポンプ8とダイヤフラムポンプ9からなる真空排気装置10の付いた四極子型質量分析計11と、被測定ガスの一部をマニホールド3から使用済みのホースを構成する素材は、全てポリエチレン系材である四極子型質量分析計11のイオン源12に流入させるためのオリフィス13と、マニホールド3に取り付けられた圧力計14から構成されている。40

#### 【0004】

このような装置における被測定ガスの流れは、次のとおりである。即ち、まず、前記両真空排気装置6、10により可変リークバルブ2の下流側配管内と四極子型質量分析計150

1 内を高真空に排気し、四極子型質量分析計 1 1 を作動状態にする。次に、可変リークバルブ 2 を適度に開き、マニホールド 3 に取り付けてある圧力計 1 4 の指示が所定の値になるようとする。この所定の値とは、四極子型質量分析計 1 1 のイオン源 1 2 の圧力がこの値とオリフィス 1 3 のコンダクタンスと排気装置の実効排気速度により測定に最適な値となるように予め設定された、本分析装置固有のものである。

#### 【0005】

この状態において、被測定ガスリザーバ 1 から放出された被測定ガスの一部がマニホールド 3 の近くに設けられたオリフィス 1 3 から四極子型質量分析計 1 1 のイオン源 1 2 に流れ込むので、そのガスのマススペクトルを分析することにより被測定ガス中の対象ガスの濃度を測定することができる。

10

#### 【0006】

しかしながら、従来のガス分析装置では、可変リークバルブ 2 を絞って被測定ガスリザーバ 1 からのガス放出量を少なくするための流量微調整が難しいため、再現性に乏しくなる。また、反対に、可変リークバルブ 2 を開いて被測定ガスリザーバ 1 からのガス放出量を多くするとマニホールド部の圧力が上昇するため、オリフィス径を極端に小さくする必要があり、オリフィス 1 3 のコンダクタンスが変化したり、オリフィス 1 3 が詰まつたりして、同様に再現性が悪くなるという難点がある。

#### 【0007】

また、従来のガス分析装置では、基本的に被測定ガスを連続的に流して、定常状態にて測定する方式を採用している。そのため、流れの再現性が仮に確保されたとしても、通常被測定ガス中に多量に含まれる水蒸気等の吸着性ガスの影響により対象ガスの検出感度が著しく低下するという問題を有している。

20

#### 【0008】

即ち、例えば、被測定ガス中に存在する微量の水素を測定しようとする場合、イオンの質量数と電荷の比  $m / e = 2$  ( $H_2^+$ ) に着目して分析を行う。しかし、被測定ガス中に多量の水蒸気が存在すると、 $m / e = 1$  ( $H^+$ ) が生成し、 $m / e = 1$  の値が大きくなるとこれに隣接する  $m / e = 2$  の指示にも影響を与える。このため、対象ガスの水素に起因する  $m / e = 2$  の正確な値が読みなくなり、結果的に検出感度の低下を招くことになる。なお、水蒸気等の吸着性ガスは、質量分析計の管壁や電極に吸着しやすく、いったん吸着すると高温に加熱しない限り簡単に脱離しない性質を有している。

30

#### 【0009】

このようなことから、本出願人は、先に、測定値の精度（再現性）向上を図るとともに、水蒸気等の吸着性ガスの影響を最小限に抑えて最高 ppm オーダーまでの微量ガスを測定できるようにしたガス分析装置を提案した（特許文献 1）。しかしながら、こうした改良したガス分析装置では、マニホールドに配管を介して接続する、ターボ分子ポンプ及びダイヤフラムポンプからなる真空排気装置を備えているので、ガス分析装置が大型化するとともに、コスト高になるという問題があった。

#### 【0010】

ここで、ガス分析装置を大型化せざるを得なかつた理由について説明する。

1) 前記被測定ガス中に水蒸気等の吸着性ガスが含まれると、測定対象ガスの検出感度及び測定値の再現性が著しく低下する。この原因は以下に述べるとおりである。即ち、測定対象ガス中に含まれている例えば水素 ( $H_2$ ) 等の非吸着性ガスは真空ポンプで直ちに測定後測定域外へ排出除去される。しかし、水蒸気等の吸着性ガスは、測定終了後も、マニホールド 3 、四極子型質量分析計 1 1 などの器壁、管壁面との吸脱着現象を繰り返し長時間に渡って測定域内に滞在する。そして、その一部は器壁面上に蓄積し、それが次の測定時に器壁面等から不定期に再放出して、測定対象ガス濃度の相対的希釈化（検出感度の低下）及びバックグラウンド値の不規則変動（再現性の低下）を引き起こしている。

40

#### 【0011】

2) そのため、次の測定時にこれらの吸着性ガスの悪影響を残さないようにするための現実的な真空排気条件は、マニホールド 3 における実効排気速度が  $0.01 \sim 0.1 L /$

50

sで圧力減衰(図4参照)の時定数は10s前後である。この条件を実現するために、専用の真空排気装置6をマニホールド3への配管7bで結び、マニホールド3内の吸着性ガスを測定中も真空排気装置6で連続的に排出除去して、測定対象ガスの検出感度及び測定値の再現性を高品位に維持している。

#### 【0012】

3) ところで、真空排気装置6が設置されていない場合は、ガス分析装置の四極子型質量分析計11についている真空排気装置10のみで、これら吸着性ガスを排出除去しなければならない。具体的には、吸着性ガスがマニホールド3、オリフィス13及びイオン源12を経由して真空排気装置10で排気されることになる。また、オリフィス13は円形の孔(直径0.3mm前後、コンダクタンス $8 \times 10^{-3}$ L/s)でコンダクタンスが最も小さい。この場合、マニホールド3における実効排気速度は $8 \times 10^{-3}$ L/sで圧力減衰(図4参照)の時定数は120s前後である。なお、実効排気速度は、最も小さいコンダクタンス値と同じ値となることが理論的に知られている。10

#### 【0013】

4) 従って、専用の真空排気装置6を持たず、オリフィス13のみを経由して吸着性ガスを排気除去しようとした場合、圧力減衰の時定数は $120\text{ s} / 10\text{ s} = 12$ 倍程度長くなる。つまり、オリフィス13のみを経由しての吸着性ガスの排気除去は時間がかかり過ぎるため、現実的でない。

#### 【先行技術文献】

#### 【特許文献】

20

#### 【0014】

#### 【特許文献1】特許第4052597号公報

#### 【発明の概要】

#### 【発明が解決しようとする課題】

#### 【0015】

本発明は、こうした事情を考慮してなされたもので、装置の大型化やコスト高を招くことなく、測定値の精度向上を図るとともに、水蒸気等の吸着性ガスの影響を最小限に抑えて最高ppmオーダーまでの微量ガスを測定できる高感度ガス分析装置、ガス定量方法及び分析装置システムを提供することを目的とする。

#### 【課題を解決するための手段】

30

#### 【0016】

本発明に係る高感度ガス分析装置は、微量ガスを定量測定する高感度ガス分析装置において、被測定ガスを収容する被測定ガスリザーバと、この被測定ガスリザーバと第1の開閉弁を介して接続する小容器と、この小容器と第2の開閉弁を介して接続する、容量が前記小容器の容量の2000倍以上のバッファタンクと、このバッファタンクと配管を介して接続するマニホールドと、このマニホールドと接続する、吸気口側に第3の開閉弁を介装したターボ分子ポンプ及びダイヤフラムポンプからなる真空排気装置の付いた四極子型質量分析計と、被測定ガスを四極子型質量分析計に流入させるためのオリフィスと、前記マニホールドとターボ分子ポンプとを接続する、第4の開閉弁を介装したバイパス配管とを具備し、前記第3の開閉弁及び前記第4の開閉弁は、前記第4の開閉弁の開又は閉動作に対応して前記第3の開閉弁の動作が前記第4の開閉弁とは正反対の閉又は開動作となるように連動動作することを特徴とする。40

#### 【0017】

また、本発明に係るガス定量方法は、前記高感度ガス分析装置を用いたガス定量方法であって、前記被測定ガスリザーバに収容されている被測定ガスを前記第1および第2の開閉弁を操作して前記小容器に一定容積の被測定ガスを採取する工程と、前記真空排気装置を作動させた後、前記第1の開閉弁を閉じてから前記第2の開閉弁を開いて前記小容器内の被測定ガスを前記バッファタンク内に拡散させる工程と、拡散した被測定ガスを前記バッファタンクと前記マニホールド間の配管を介して前記マニホールドに移す工程と、前記マニホールド内の被測定ガスを、前記オリフィスを介して前記四極子型質量分析計のイオ

50

ン源に供給して被測定ガスをイオン化する工程と、イオン化した被測定ガスのイオン電流を測定することにより被測定ガス中の対象ガスの定量を行う工程とを具備し、前記マニホールド内の被測定ガスを、前記オリフィスを介して前記四極子型質量分析計のイオン源に供給して被測定ガスをイオン化する工程において、前記マニホールド内の被測定ガス圧が前記四極子型質量分析計の正常動作圧力の上限値を超えた場合に、前記バイパス配管を経由して余分な量の被測定ガスを系外へ排出するため、前記四極子型質量分析計とターボ分子ポンプとの間に介装された第3の開閉弁及び前記マニホールドとターボ分子ポンプとを接続するバイパス配管に介装された第4の開閉弁を、前記第4の開閉弁の開又は閉動作に対応させて前記第3の開閉弁の動作を前記第4の開閉弁とは正反対の閉又は開動作とするように連動動作させることを特徴とする。

10

## 【0018】

更に、本発明に係る高感度ガス分析装置システムは、前記高感度ガス分析装置と、この高感度ガス分析装置による分析の解析を行うホストコンピュータと、前記高感度ガス分析装置と前記ホストコンピュータ間で分析情報及び解析結果情報のやり取りを行う有線又は無線による連絡機構とを具備することを特徴とする。

## 【発明の効果】

## 【0019】

本発明によれば、装置の大型化やコスト高を招くことなく、測定値の精度向上を図るとともに、水蒸気等の吸着性ガスの影響を最小限に抑えて最高 ppm オーダーまでの微量ガスを測定できる高感度ガス分析装置、ガス定量方法及び分析装置システムを得ることができる。

20

## 【図面の簡単な説明】

## 【0020】

【図1】図1は本発明の一実施形態に係る高感度ガス分析装置の概略図。

【図2】図2は、本発明に係る高感度ガス分析装置システムの説明図。

【図3】図3は従来のガス分析装置の概略図。

【図4】図4は本発明に係る高感度ガス分析装置のバッファタンク及びマニホールド内の圧力の時間的变化を概略的に示した図。

## 【発明を実施するための形態】

## 【0021】

30

以下、本発明の高感度ガス分析装置、ガス定量方法及び分析装置システムについて更に詳しく説明する。

本発明において、バッファタンクの容量を小容器の容量の2000倍以上とするのは、以下の理由による。

本発明の分析装置の一構成である四極子型質量分析計は、イオン化した（電荷を持った）被測定ガスを、高周波電場と直流電場を重ね合わせた電場域を通過させると、被測定ガス重量（分子量）の違い毎にイオンの飛行軌跡が異なってくることを利用して混合ガス中の成分ガス種を分別検出する装置である。従って、四極子型質量分析計では、電気的に中性な被測定ガスをイオン化させることが極めて重要である。

## 【0022】

40

電気的に中性な被測定ガスをイオン化させる方法としては、約1000以上に高温加熱した金属製フィラメントから熱電子を放出させ、それに外部電圧を印加して熱電子を加速し、中性な被測定ガスに衝突させて中性ガス分子から電子を叩き出し、プラス電荷を持ったイオンに変化させることが挙げられる。

## 【0023】

従って、四極子型質量分析計のイオン源内では、四極子型質量分析計の運転に必須な熱電子発生のために約1000以上に高温加熱されたタンゲステン等の金属製フィラメントが点灯されている。不活性気体以外の酸素、ハロゲン等の反応性ガスがイオン源内に一定の上限圧以上存在すると、高温の金属製フィラメントは、急激な腐食反応を起こしフィラメントが腐食破断に至ることが知られている。これにより、高温の金属製フィラメント

50

からの熱電子発生が中断され、四極子型質量分析計の正常な運転が阻害される。

**【0024】**

この腐食反応が顕著に起きだす反応性ガスの上限圧は、反応ガス種にあまり依存することなく、約 50 Pa であるということが経験的に知られており、したがってこの腐食反応を抑えるためにイオン源のガス入口を約 50 Pa 以下にする必要がある。このため、本発明では、大気圧（略 1 気圧、0.1 MPa）状態で小容器内に採取された被測定ガスの圧を約 50 Pa 以下に低減させる必要がある。そこで、バッファタンクの容量を小容器の約 2000 倍 ( $0.1 \times 10^6 \text{ Pa} / 50 \text{ Pa} = 2000$  倍) とし、小容器からバッファタンク内へ被測定ガスを導入膨張させることで、イオン源の入口部で約 50 Pa となるように圧力調整を行なっている。

10

**【0025】**

本発明において、マニホールドとターボ分子ポンプ間に第 4 の開閉弁を介装したバイパス配管を設けるのは、被測定ガスリザーバには一般的に多めの被測定ガスを収容することがあり、これに起因してマニホールド内の被測定ガス圧が四極子型質量分析計の正常動作圧力の上限を超える場合があるからである。

**【0026】**

（第 1 の実施形態）

図 1 を参照する。

図中の符番 21 は、大気圧 (0.1 MPa) 状態で被測定ガスを収容する被測定ガスリザーバを示す。この被測定ガスリザーバ 21 には、第 1 の開閉弁 22 を介して小容器 23 (内容積：約 0.1 m<sup>3</sup>) が接続されている。この小容器 23 には、第 2 の開閉弁 24 を介してバッファタンク 25 (内容積：約 200 m<sup>3</sup>) が接続されている。このバッファタンク 25 には、大きなコンダクタンスの配管 26 を介して圧力計（図示せず）を備えたマニホールド 27 が接続されている。ここで、前記被測定ガスリザーバ 21、小容器 23、バッファタンク 25 及びマニホールド 27 より被測定ガス流路 28 が構成されている。ここで、バッファタンク 25 の容量は、小容器 23 の容量の 2000 倍以上となっている。

20

**【0027】**

前記マニホールド 27 には、配管 29 を介して真空排気装置付四極子型質量分析計 30 が接続されている。この質量分析計 30 の下流側には、吸気口側に第 3 の開閉弁 36 を備えたターボ分子ポンプ 32 と、このターboro 分子ポンプ 32 に接続するダイヤフラムポンプ 33 から構成された真空排気装置 31 が配置されている。ここで、真空排気装置 31 の実効排気速度は 20 ~ 100 L/s である。マニホールド 27 とターboro 分子ポンプ 32 の吸気口は、マニホールド側に位置した第 4 の開閉弁 37 を介装したバイパス配管 38 により接続されている。前記質量分析計 30 はイオン源 34 を備えている。マニホールド 27 と質量分析計 30 を接続する配管 29 には、円形の孔（直径 0.3 mm 前後）を有する薄い金属板（オリフィス）35 が配置されている。このオリフィス 35 により、被測定ガス流路 28 の中間から被測定ガスの一部が質量分析計 30 のイオン源 34 に導入される。

30

**【0028】**

こうしたガス分析装置における被測定ガスの流れは次のとおりである。即ち、まず、被測定ガスリザーバ 21 に入っている被測定ガスを第 1 の開閉弁 22 を開いて（第 2 の開閉弁 24 は閉じておく）小容器 23 に一定容積の大気圧（略 1 気圧、0.1 MPa）の被測定ガスを採取する。つづいて、真空排気装置 31 が作動していることを確認してから第 1 の開閉弁 22 を閉じ、この後第 2 の開閉弁 24 を高速で全開する。これにより、小容器 23 内の被測定ガスは、バッファタンク 25 内に速やかに拡散する。このとき、バッファタンク 25 内の圧力は、図 4 に示すように、いったん極大値に達し、以後、真空排気装置 31 により排気されるので、徐々に低下していく。バッファタンク 25 とマニホールド 27 は大きなコンダクタンスの配管 26 で接続されているので、マニホールド 27 内の圧力はバッファタンク 25 内の圧力とほぼ同様な変化をする。従って、第 2 の開閉弁 24 を開いた直後のバッファタンク 25 及びマニホールド 27 内の圧力はおよそ 50 Pa である。

40

**【0029】**

50

この後、バッファタンク 25 内に拡散した被測定ガスを、マニホールド 27 に移す。次に、マニホールド 27 内の被測定ガスを、オリフィス 35 を介して四極子型質量分析計 30 のイオン源 34 に供給し、電気的に中性な被測定ガスをイオン化する。ここで、イオン化した被測定ガスのイオン電流を測定して被測定ガス中の対象ガスの定量を繰り返し行う。なお、マニホールド 27 内の被測定ガス圧が四極子型質量分析計 30 の正常動作圧力の上限を超えた場合には、第 4 の開閉弁 37 の開閉によりバイパス配管 38 を経由して、余分な量の被測定ガスを系外へ排出除去する。

#### 【0030】

上記実施形態に係る高感度ガス分析装置は、上述したように、被測定ガスリザーバ 21 と、この被測定ガスリザーバ 21 に第 1 の開閉弁 22 を介して接続する小容器 23 と、この小容器 23 に第 2 の開閉弁 24 を介して接続する、容量が小容器 23 の容量の約 200 倍のバッファタンク 25 と、このバッファタンク 25 に配管 26 を介して接続するマニホールド 27 と、このマニホールド 27 に接続する、吸気口側に第 3 の開閉弁 36 を介装したターボ分子ポンプ 32 及びダイヤフラムポンプ 33 からなる真空排気装置 31 の付いた四極子型質量分析計 30 と、被測定ガスの一部を前記質量分析計 30 に流入させるオリフィス 35 と、マニホールド 27 とターボ分子ポンプ 32 とを接続する、第 4 の開閉弁 37 を介装したバイパス配管 38 を具備している。

#### 【0031】

こうした高感度ガス分析装置によれば、バッファタンク 25 の容量を小容器 23 の容量の 2000 倍とすることにより、従来のようにマニホールドに配管を介して接続する真空排気装置を用いることなく、測定値の精度向上を図るとともに、水蒸気等の吸着性ガスの影響を最小限に抑えて最高 ppm オーダーまでの微量ガスを測定することができる。また、上記真空排気装置を取り除くことができるので、装置の構成部材を簡略化でき、装置の大型化やコスト高を回避することができる。更に、本発明のガス分析装置では、マニホールド 27 とターボ分子ポンプ 32 間にバイパス配管 38 を設けることにより、マニホールド 27 内の被測定ガス圧が四極子型質量分析計 30 の正常動作圧力の上限を超えた場合に、第 4 の開閉弁 37 の開閉によりバイパス配管 38 を経由して、余分な量の被測定ガスを系外へ排出除去している。この場合、第 4 の開閉弁 37 の開又は閉動作に対応して第 3 の開閉弁 36 の動作が常に第 4 の開閉弁 37 とは正反対の閉又は開動作となるように第 3 の開閉弁 36 及び第 4 の開閉弁 37 を連動動作させることにより、除去した被測定ガスが四極子型質量分析計 30 へ逆流侵入することを阻止できる。

#### 【0032】

(第 2 の実施形態)

図 2 を参照する。

本実施形態に係る高感度ガス分析装置システムは、高感度ガス分析装置 41 と、この分析装置 41 による分析の解析を行うホストコンピュータ 42 と、前記高感度ガス分析装置とホストコンピュータ間で分析情報及び解析結果情報のやり取りを行う有線又は無線による連絡機構 43 とを備えている。ここで、連絡機構 43 としては、携帯電話、パソコン、FAX あるいはネットコンピュータなどが挙げられるが、分析情報及び解析結果情報のやり取りができるれば特に限定されない。

#### 【0033】

第 2 の実施形態によれば、高感度ガス分析装置 41 を用いた作業者による分析情報をホストコンピュータ 42 に送り、またホストコンピュータ 42 による分析者の分析結果を作業者に伝達できるので、分析者は高感度ガス分析装置 41 が配置された現地まで出向くことなく、分析結果を作業者に伝達することができる。従って、たとえ作業者が装置 41 による分析に十分習得していないても短時間で正確な分析結果が得られ、また分析者も現地まで出向いて分析する手間を省き、移動時間の無駄を無くすことができる。

#### 【0034】

なお、この発明は、上記実施形態そのままで限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示

10

20

30

40

50

されている複数の構成要素を適宜に組み合わせることにより種々の発明を形成できる。例えば、バッファタンクの容量と小容器の容量との比は、上述した比に限らず、2000倍以上であればよい。


【符号の説明】

【0035】

21...被測定ガスリザーバ、22...第1の開閉弁、23...小容器、24...第2の開閉弁、25...バッファタンク、26, 29...配管、27...マニホールド、28...被測定ガス流路、30...四極子型質量分析計、31...真空排気装置、32...ターボ分子ポンプ、33...ダイヤフラムポンプ、34...イオン源、35...オリフィス、36...高感度ガス分析装置、37...第3の開閉弁、38...第4の開閉弁、39...バイパス配管、40...高感度ガス分析装置、41...ホストコンピュータ、42...連絡機構。  
10  
— タ、43...連絡機構。


【図1】

図1

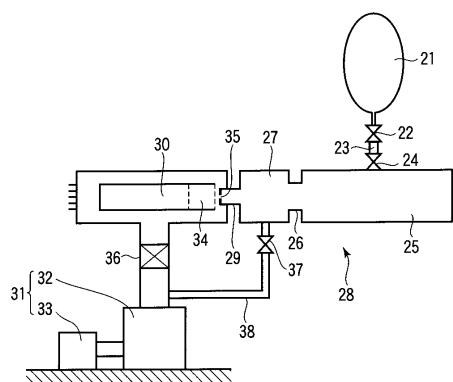


【図3】

図3

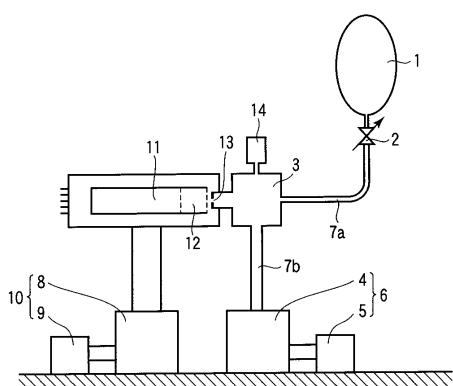


【図2】

図2

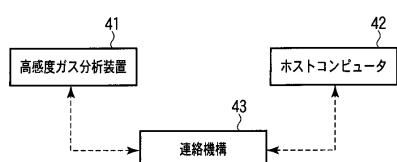

【図4】

図4

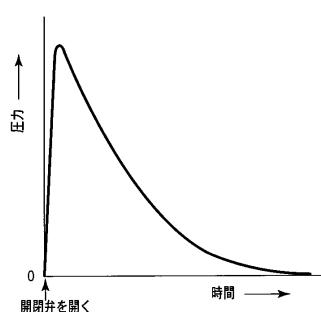

---

フロントページの続き

(74)代理人 100075672  
弁理士 峰 隆司  
(74)代理人 100095441  
弁理士 白根 俊郎  
(74)代理人 100084618  
弁理士 村松 貞男  
(74)代理人 100103034  
弁理士 野河 信久  
(74)代理人 100119976  
弁理士 幸長 保次郎  
(74)代理人 100153051  
弁理士 河野 直樹  
(74)代理人 100140176  
弁理士 砂川 克  
(74)代理人 100101812  
弁理士 勝村 紘  
(74)代理人 100124394  
弁理士 佐藤 立志  
(74)代理人 100112807  
弁理士 岡田 貴志  
(74)代理人 100111073  
弁理士 堀内 美保子  
(74)代理人 100134290  
弁理士 竹内 将訓  
(74)代理人 100127144  
弁理士 市原 卓三  
(74)代理人 100141933  
弁理士 山下 元  
(72)発明者 阿部 哲也  
茨城県那珂郡東海村白方白根 2 番地 4 独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センタ  
- 原子力科学研究所内  
(72)発明者 秦野 歳久  
茨城県那珂郡東海村白方白根 2 番地 4 独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センタ  
- 原子力科学研究所内  
(72)発明者 平塙 一  
茨城県那珂郡東海村白方白根 2 番地 4 独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センタ  
- 原子力科学研究所内  
(72)発明者 大間知 聰一郎  
埼玉県ふじみ野市亀久保 1651 日本金属化学株式会社内

審査官 波多江 進

(56)参考文献 特開2006-053003 (JP, A)  
特開2004-028675 (JP, A)  
特開2005-098705 (JP, A)  
特開2008-151590 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.CI., DB名)

(10)

JP 5648992 B2 2015.1.7

G 0 1 N    2 7 / 6 2    -    2 7 / 7 0  
H 0 1 J    4 9 / 0 0    -    4 9 / 4 8  
J S T P l u s / J S T 7 5 8 0 ( J D r e a m I I I )